NO TE
EXPON GAS

Adquiere y utiliza adecuadamente
los gases industriales y medicinales.

EN CLÍNICAS Y HOSPITALES

¡Cuido a mis pacientes y me comprometo con su seguridad!

Por eso sigo estas **5** indicaciones para el uso correcto de gases medicinales en las instituciones prestadoras de servicios de salud.

Siguiente ▶

Una campaña de:

ANDI | MÁS PAÍS

CÁMARA DE GASES
INDUSTRIALES Y MEDICINALES

1.

Antes de utilizar un cilindro de oxígeno, verifico que esté en buen estado, con su información clara y sin rastros de adulteración. Además, leo detenidamente las instrucciones que están en la etiqueta.

2.

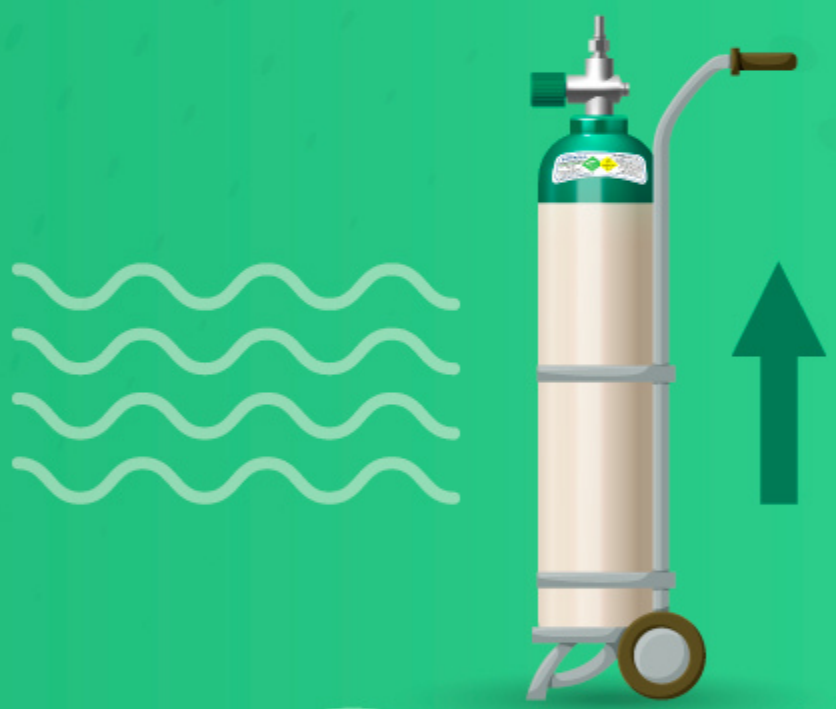

Ubico los cilindros en posición vertical, en un espacio ventilado, bajo techo y alejados de fuentes de calor y sustancias químicas inflamables. Me aseguro de que estén protegidos ante golpes y caídas.

3.

Nunca combino cilindros llenos y vacíos, ni conecto uno vacío a un sistema presurizado.

Siguiente ▶

4.

Al transportar o mover los cilindros, utilizo carros o carretillas apropiadas para evitar arrastrarlos o dejarlos caer, lo que puede dañar el cilindro y provocar fugas o explosiones.

5.

Siempre tengo en cuenta que el llenado y mantenimiento de los cilindros debe ser realizado únicamente por la empresa de gases medicinales propietaria del envase y me comunico con ellos ante cualquier inquietud.